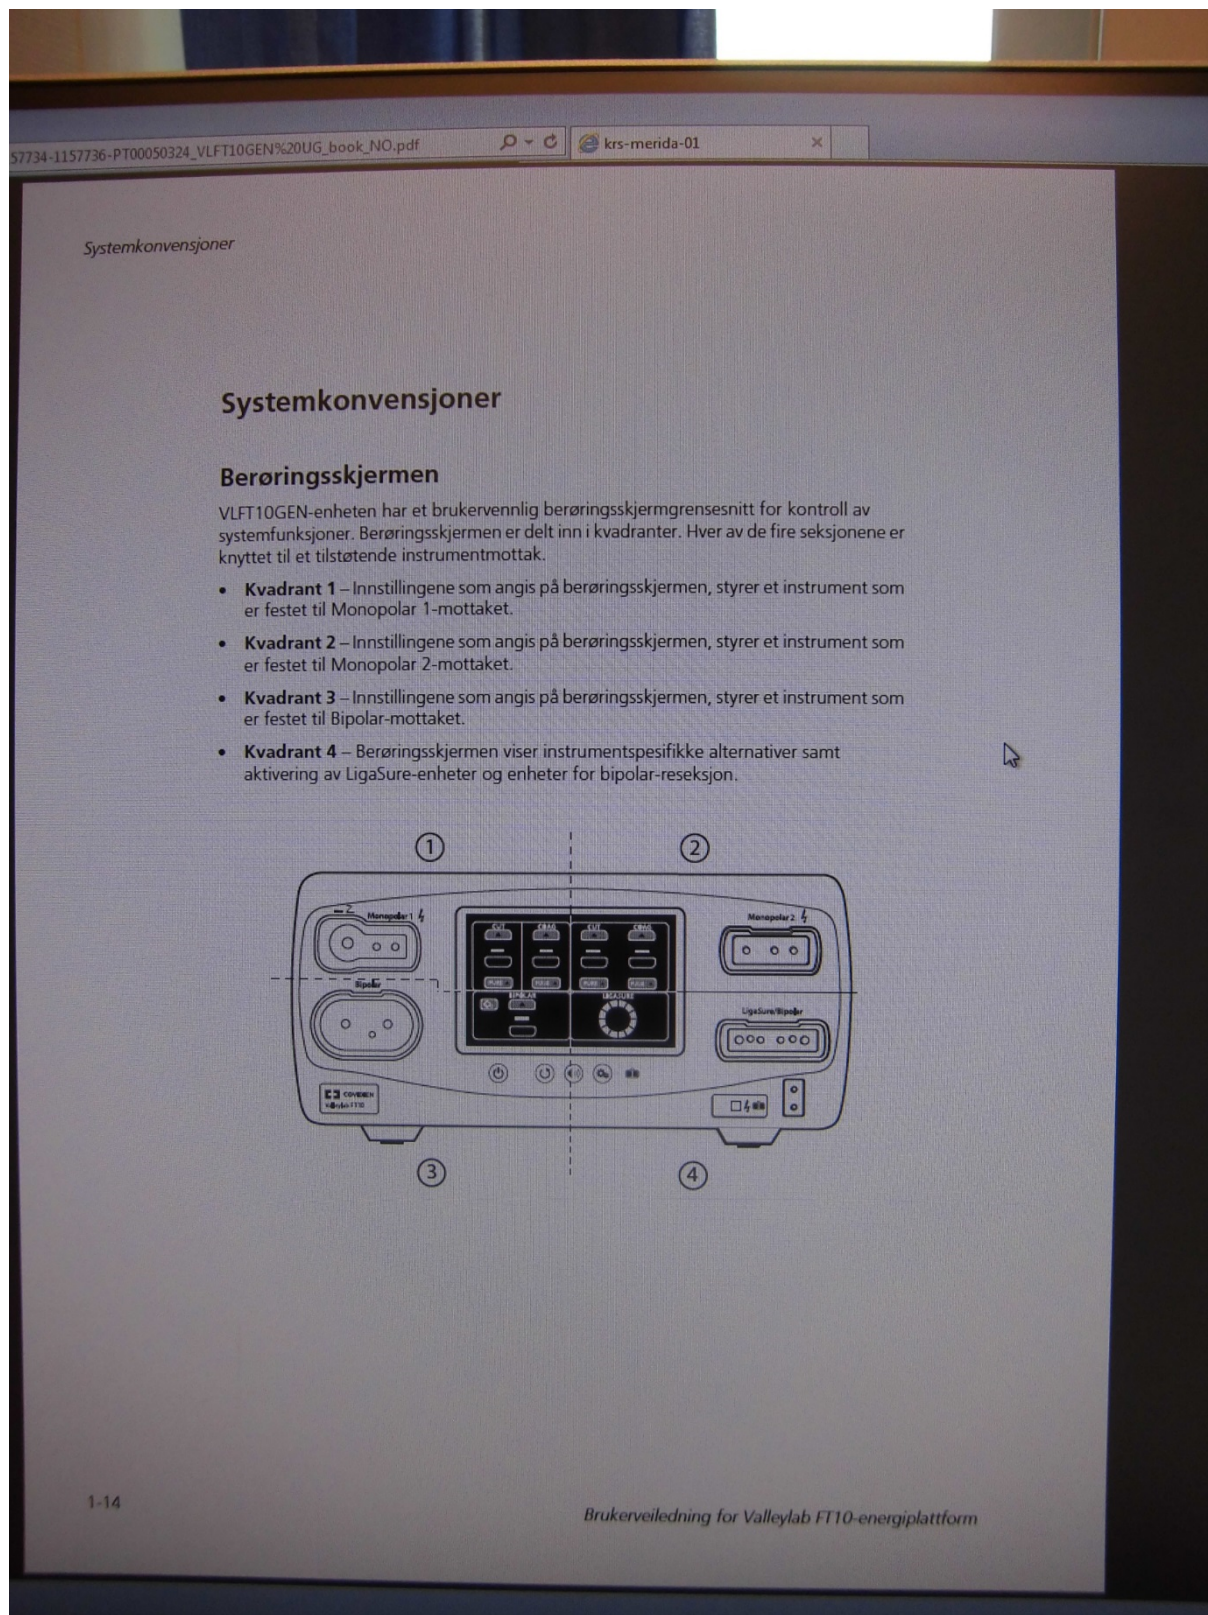


Valleylab covidien FT 10

Side 1 av 1

Dokumentplassering:
II.SOA.AIO.OPA.3.3-7Godkjent dato:
13.03.2024Revideres innen:
13.03.2026Sist endret:
13.03.2024Revisjon:
0.02Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Støttefunksjoner
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Kortfattet bruksanvisning for Vallylab Covidien FT 10

Utarbeidet av:
Olga Karin HarnesFagansvarlig:
[]Verifisert av:
[]Godkjent av:
Ikke styrtDok.nr:
D52169